



CÔNG TY TNHH ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG VIỆT NAM
QUALITY ASSURANCE OF VIETNAM COMPANY LIMITED

ĐK-103

GIẤY CHỨNG NHẬN BẢO TRÌ
CERTIFICATE OF MAINTENANCE

Ngày/ Date:

Số/ N^o: A1017205085



Trang/ Page: 1/4

1. Phương tiện đo/ Object: BỂ TUẦN HOÀN NHIỆT/ CIRCULATING BATH

2. Hãng sản xuất/ Manufacturer: PolyScience

3. Kiểu/ Model: AD07R-20-A12E

Số nhận dạng/ ID: 85

4. Số hiệu/ SN: 2D1721900

5. Đặc trưng kỹ thuật/ Specification:

+ Khoảng nhiệt độ/ Temp. range: -20÷200 °C

+ Độ phân giải/ Resolution: 0,01°C

+ Kích thước trong/ Internal dimension: 7 Lít

6. Khách hàng/ Customer: CÔNG TY TNHH ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG VIỆT NAM

7. Địa chỉ/ Address: Tầng 4, 130 Nguyễn Đức Cảnh, Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội

8. Nơi bảo trì/ Place of maintenance: Phòng hiệu chuẩn 1

9. Địa chỉ/ Address: Tầng 4, 130 Nguyễn Đức Cảnh, Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội

10. Phương pháp bảo trì/ - Maintenance method: A10-73 - Hướng dẫn bảo trì bể điều nhiệt

11. Chuẩn sử dụng/ Standards Used:

Chuẩn/ Standards	Mã nhận dạng/ ID	Liên kết chuẩn/ Traceable to	Hiệu lực đến/ Due date
Đồng hồ đo nhiệt độ & độ ẩm / Thermo-Hygrometer	TB-46	AoV	10/2022
Nhiệt kế PRT chuẩn / Standard Platinum Resistance Thermometers	TB-63	VMI	07/2022

12. Môi trường bảo trì/ maintenance environment:

Nhiệt độ/ Temperature: [24,6 ÷ 24,5] °C

Độ ẩm/ Humidity: [56,0 ÷ 57,4] %RH

13. Ngày bảo trì/ Date of maintenance: 29/04/2022

14. Ngày bảo trì tiếp theo/ Recommended date of next maintenance: 29/04/2023

15. Tem bảo trì/ maintenance label: A085

- Aov**
- Kết quả bảo trì ghi trong giấy chứng nhận này chỉ có giá trị đối với thiết bị đã được bảo trì trên đây.
The maintenance results in this certificate are applicable to the above maintenance instrument only.
 - Không được trích sao một phần giấy chứng nhận này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của AoV.
This certificate shall not be reproduced, except in full without the written approval of AoV.
 - Tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
Name of customer is written as customer's request.



GIẤY CHỨNG NHẬN BẢO TRÌ CERTIFICATE OF MAINTENANCE

Ngày/ Date:

Số/ N^o: A1017205085



Trang/ Page: 2/4

KẾT QUẢ BẢO TRÌ/ RESULTS OF MAINTENANCE

16. Nội dung bảo trì/ Content maintenance

16.1. Kiểm tra bên ngoài/ Check outside

◊ Thông tin thiết bị/ Equipment information

Đây đủ, rõ ràng/ fully, clearly

Không có, không rõ ràng/ Not available, not clear

16.2. Kiểm tra kỹ thuật hệ thống nhiệt/ Technical inspection of heating system

◊ Hệ thống cài đặt hiển thị hoạt động/ Display operation system

Bình thường/ Normal

Không bình thường/ Not normal

◊ Hệ thống gia nhiệt hoạt động/ Operation of heating system

Bình thường/ Normal

Không bình thường/ Not normal

16.3. Bảo trì khoang làm việc phần nhiệt/ Maintenance the workplace heating part

◊ Vệ sinh khoang làm việc/ Clean the workspace

◊ Kiểm tra vệ sinh đầu dò nhiệt/ Hygiene test of temperature probe

◊ Kiểm tra vệ sinh hệ thống gia nhiệt/ Hygiene check heating system

◊ Kiểm tra vệ sinh motor khuấy/ Check cleaning of stirring motor

◊ Kiểm tra vệ sinh đường ống dẫn hoàn lưu/ Check and clean the pipeline

16.4. Bảo trì bên trong thiết bị/ Maintenance the inside of the device

◊ Kiểm tra vệ sinh bơm hoàn lưu/ Hygiene check circulation pump

◊ Kiểm tra, gia cố các kết nối nguồn đến board nguồn, đến bơm hoàn lưu / Check and reinforce the power connections to the source board, to the circulation pump

◊ Vệ sinh khoang trong của thiết bị/ Clean the cage of the device

◊ Kiểm tra vệ sinh hệ thống làm mát bơm hoàn lưu/ Hygiene check circulation pump cooling system

◊ Kiểm tra vệ sinh board màn hình và board điều khiển/ Check cleaning of the display board and control board

◊ Vệ sinh block làm lạnh, hệ thống tản nhiệt cho block lạnh/ Cleaning cooling block, radiator system

16.5. Bảo trì xung quanh thiết bị/ Maintenance around

◊ Vệ sinh, làm sạch bề mặt làm việc và xung quanh bề mặt thiết bị/ Clean working surface and around equipment surface

◊ Vệ sinh hệ thống nước xả/ Clean the drain system

◊ Vệ sinh màn hình và hệ thống điều khiển/ Clean the screen and control system

16.6. Kiểm tra nhiệt độ sau khi bảo trì | Temperature checking after maintenance

16.6.1 Độ chính xác nhiệt độ/ Temperature accuracy

1. Kết quả bảo trì ghi trong giấy chứng nhận này chỉ có giá trị đối với thiết bị đã được bảo trì trên đây.
The maintenance results in this certificate are applicable to the above maintenance instrument only.
2. Không được trích sao một phần giấy chứng nhận này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của AoV.
This certificate shall not be reproduced, except in full without the written approval of AoV.
3. Tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của noi gửi mẫu.
Name of customer is written as customer's request.



CÔNG TY TNHH ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG VIỆT NAM
QUALITY ASSURANCE OF VIETNAM COMPANY LIMITED

ĐK-103

GIẤY CHỨNG NHẬN BẢO TRÌ
CERTIFICATE OF MAINTENANCE

Ngày/ Date:

Số/ N^o: A1017205085



Trang/ Page: 3/4

Nhiệt độ cài đặt/ Set temp., °C	Nhiệt độ hiển thị/ Indication, °C	Giá trị chuẩn/ Reference value ⁽¹⁾ , °C	Sai số/ Error ⁽²⁾ , °C	U/ Uncertainty ⁽³⁾ , °C
25	25,00	24,729	+0,271	0,270

16.6.2 Đặc trưng hoạt động/ Performance

Nhiệt độ hiển thị/ Indication., °C	Độ đồng đều nhiệt độ/ Uniformity ⁽⁴⁾ , °C	Độ ổn định nhiệt độ/ Stability ⁽⁵⁾ , °C	Biến động nhiệt độ tổng thể/ Overall variation ⁽⁶⁾ , °C
25,00	0,005	0,007	0,018

Ghi chú/ Notes:

⁽¹⁾: Giá trị trung bình của (3 x 10) kết quả đo (3 vị trí, 10 lần đo)/ The average of (3 x 10) measured temperatures (3 positions, 10 records).

⁽²⁾: Hiệu giữa nhiệt độ hiển thị và trung bình đo được/ Difference of indication and average temperature.

⁽³⁾: Độ không đảm bảo đo mở rộng được tính từ độ không đảm bảo đo chuẩn nhân với hệ số mở rộng k = 2, mức tin cậy P = 0,95/ Expanded uncertainty of measurement is stated as standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor k=2, which for a normal distribution corresponds to a probability of approximately 95%.

⁽⁴⁾: Một phần hai chênh lệch lớn nhất giữa các nhiệt độ đo được tại các vị trí khác nhau trong cùng một thời điểm/ One-half of the greatest maximum difference of measured temperatures at difference positions at the same time of recording.

⁽⁵⁾: Một phần hai chênh lệch lớn nhất giữa các nhiệt độ đo được tại các thời điểm khác nhau ở cùng một vị trí/ One-half of the greatest maximum difference of measured temperatures at different times of recording at the same position.

⁽⁶⁾: Chênh lệch lớn nhất giữa các nhiệt độ đo được tại tất cả các vị trí và tất cả các thời điểm/ The difference of the maximum and the minimum measured temperatures throughout observation time.

BẢNG SỐ LIỆU/ DATA TABLE

Lần đo/ No	Nhiệt độ hiển thị/ Indication., °C	Giá trị chuẩn/ Reference value, °C		
		1	2	3
1	25,00	24,728	24,727	24,725
2	25,00	24,731	24,730	24,727
3	25,00	24,729	24,730	24,724
4	25,00	24,734	24,735	24,732
5	25,00	24,728	24,727	24,719
6	25,00	24,736	24,733	24,731
7	25,00	24,727	24,726	24,723
8	25,00	24,736	24,735	24,727
9	25,00	24,725	24,725	24,718
10	25,00	24,731	24,732	24,728
Trung bình/ Average		24,731	24,730	24,725

- Kết quả bảo trì ghi trong giấy chứng nhận này chỉ có giá trị đối với thiết bị đã được bảo trì trên đây.
The maintenance results in this certificate are applicable to the above maintenance instrument only.
- Không được trích sao một phần giấy chứng nhận này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của AoV.
This certificate shall not be reproduced, except in full without the written approval of AoV.
- Tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của noi gửi mẫu.
Name of customer is written as customer's request.




GIẤY CHỨNG NHẬN BẢO TRÌ CERTIFICATE OF MAINTENANCE

Ngày/ Date:

Số/ N^o: A1017205085



Trang/ Page: 4/4

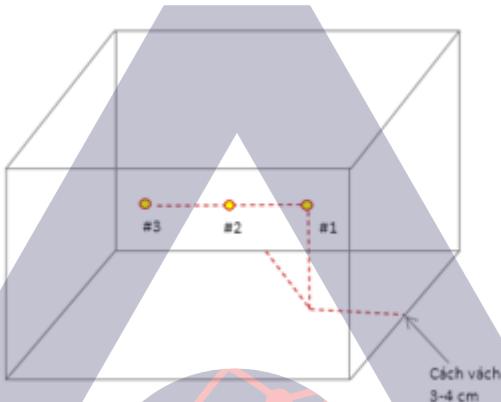

Bố trí các điểm đo/ Sensor installation locations

16.7. Kết luận sau bảo trì/ Concluded after maintenance

◊ Thiết bị hoạt động bình thường/ The equipment operates normally.

--- Hết/ End ---

AoV

1. Kết quả bảo trì ghi trong giấy chứng nhận này chỉ có giá trị đối với thiết bị đã được bảo trì trên đây.
The maintenance results in this certificate are applicable to the above maintenance instrument only.
2. Không được trích sao một phần giấy chứng nhận này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của AoV.
This certificate shall not be reproduced, except in full without the written approval of AoV.
3. Tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
Name of customer is written as customer's request.