



CERTIFICATE OF CALIBRATION

Giấy Chứng Nhận Hiệu Chuẩn
Report No. C081118-0037



Manufacturer / NSX: EDC-HCM
Description / Mô tả: Temperature / Nhiệt độ
Model # / Kiểu: HB1805-01
Serial # / Số seri: EDC-08082018

WO # / Mã số: W071118-006
PO # / Mã đơn hàng: PO071118-006
Procedure / Quy trình: KQT-33K5-4-84-1
Asset # / Mã số TS: TB-104

Condition Received / Tình trạng khi nhận:	In Tolerance	Calibration Place / Nơi Hiệu Chuẩn:	Onsite	Recalibration request / HC theo yêu cầu	12 months
Condition Returned / Tình trạng khi giao:	In Tolerance	Calibration Date / Ngày Hiệu chuẩn:	01/Aug/2018	Recalibration date / Ngày HC khuyến nghị:	01/Aug/2019
Actual Temperature / Nhiệt độ thực tế:	23 °C	Actual Humidity / Độ ẩm thực tế:	52 %RH	Certified by QC / QC lập chứng nhận:	Cao Cam Giang

Customer / Công ty: TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN SẮC KÝ.

Address / Địa chỉ: 340/6 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP HCM

Standard utilized / Chuẩn sử dụng

Standard # / Chuẩn	Manufacturer / NSX	Model # / Số Model	Due Date / Ngày hết hạn	Traceable to / Chuẩn liên kết
TE0025	VAISALA	HMI41	27/Mar/2019	KT3-0637AHL8
TE0027.1	AGILENT	34970A	30/Jul/2019	C080618-0039

Special Requirement / Yêu cầu đặc biệt:

This certifies that the above instrument was calibrated in compliance with the Calibration System Requirement of ISO/IEC 17025:2005 in accordance with referenced procedures. Standards used to perform this calibration are certified by or traceable to VMI/QT3, natural physical constants, consensus standards or derived by the ratio type calibrations. Expanded uncertainties are determined as required with a distribution that corresponds to a probability of approximately 95% (2 sigma), no sampling plan or other process was used for this calibration, the results reported herein apply only to the calibration of item described above. All calibrations are performed to manufacturer's specifications, unless otherwise noted. Customer has been contacted concerning re-certification interval and documentation has been received and is on file. This certificate shall not be reproduced without the prior express written consent of Kim Long Calibration And Technologies.

Giấy Chứng Nhận này xác nhận rằng Thiết bị ở trên đã được hiệu chuẩn phù hợp với các yêu cầu của hệ thống hiệu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 theo các thủ tục tham chiếu. Các Chuẩn được sử dụng để thực hiện hiệu chuẩn này được chứng nhận hoặc truy xuất với VMI/QT3, các hằng số vật lý tự nhiên, tiêu chuẩn thống nhất, hoặc có nguồn gốc do loại tỷ lệ hiệu chuẩn. Độ Không đảm bảo đo mở rộng được xác định theo yêu cầu với sự phân phối tương ứng xác suất khoảng 95% (2 sigma), không có kế hoạch lấy mẫu hoặc quá trình khác đã được sử dụng cho hiệu chuẩn này, kết quả báo cáo trong tài liệu này chỉ áp dụng cho việc hiệu chuẩn thiết bị mô tả ở trên. Tất cả hiệu chuẩn được thực hiện theo thông số kỹ thuật của Nhà sản xuất, trừ khi có ghi chú khác. Khách hàng đã được liên lạc về khoảng thời gian tái chứng nhận (Next due date), tài liệu đã nhận và đã được lưu trong hồ sơ. Giấy Chứng Nhận này không được phép sao chép nếu không có sự đồng ý bằng văn bản rõ ràng trước của Kim Long Calibration And Technologies.




Signature or Stamp:

Calibrated by/Người HC:


Huyhn Trung Kien

Signature or Stamp:

Approved by/Phê duyệt:



Tran Minh Cuong

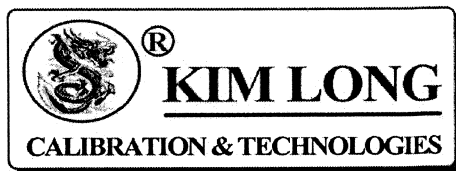

Calibration Report / Biên bản hiệu chuẩn

Report No / Số biên bản: C081118-0037

Manufacturer: EDC-HCM

Nhà sản xuất:

Model: HB1805-01

Kiểu:

Asset No / Serial No.: TB-104 / EDC-08082018


Số quản lý/ Số seri:

1 Temperature Calibration / Hiệu chuẩn nhiệt độ

Set-point= 20.0 °C

Time / Thời gian	Vị trí 1	Vị trí 2	Vị trí 3	Vị trí 4	Vị trí 5	Vị trí 6	Vị trí 7	Vị trí 8	Vị trí 9	Tmax - Tmin
5 min	20.0	20.1	19.9	20.1	20.1	20.1	19.9	20.1	19.9	0.2
10 min	19.9	19.9	20.1	20.1	20.1	20.1	19.9	20.0	20.1	0.2
15 min	20.1	20.1	19.9	20.0	19.9	19.9	20.0	20.1	20.0	0.2
20 min	20.0	20.1	19.9	20.0	20.1	20.1	19.9	20.0	20.0	0.2
25 min	20.1	19.9	19.9	19.9	20.0	19.9	19.9	20.0	20.1	0.2
30 min	19.9	19.9	19.9	20.1	20.0	20.0	20.1	20.1	20.0	0.2
Tmax - Tmin	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	

Average Temperature Nhiệt độ trung bình	20.0 °C	Expanded Uncertainty Độ không đảm bảo đo mở rộng	0.12 °C
Temperature Fluctuation Độ dao động	0.2 °C		
Temperature Uniformity Độ đồng đều	0.2 °C		
Temperature Stability Độ ổn định	0.2 °C		

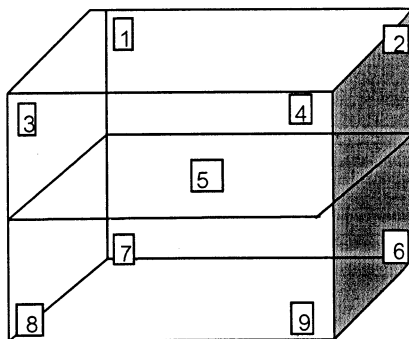


The reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor $k = 2.00$, providing a level of confidence of approximately 95 %

/ Độ không đảm bảo đo mở rộng ước lượng được tính với $k = 2$, mức tin cậy 95%

Remarks:

- As Found: Value before adjust
- As Left: Value after adjusted
- UUT: Unit Under Test / Thiết bị cần hiệu chuẩn

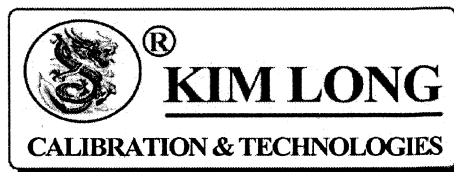

Calibration Report / Biên bản hiệu chuẩn
Report No / Số biên bản: C081118-0037

Manufacturer: EDC-HCM
 Nhà sản xuất:


Model: HB1805-01
 Kiểu:

Asset No / Serial No.: TB-104 / EDC-08082018
 Số quản lý/ Số seri:

2 Temperature Calibration / Hiệu chuẩn nhiệt độ
 Set-point= 25.0 °C

Time / Thời gian	Vị trí 1	Vị trí 2	Vị trí 3	Vị trí 4	Vị trí 5	Vị trí 6	Vị trí 7	Vị trí 8	Vị trí 9	Tmax - Tmin
5 min	25.0	25.0	24.9	25.1	25.0	24.9	24.9	24.9	25.0	0.2
10 min	25.0	24.9	24.9	24.9	25.1	24.9	24.9	25.0	24.9	0.2
15 min	25.1	24.9	25.1	25.1	25.1	25.0	25.0	24.9	25.0	0.2
20 min	25.1	24.9	25.0	25.0	25.1	24.9	25.1	25.1	24.9	0.2
25 min	25.1	24.9	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	24.9	25.1	0.2
30 min	24.9	25.1	25.1	24.9	25.0	24.9	25.0	25.0	25.0	0.2
Tmax - Tmin	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	

Average Temperature Nhiệt độ trung bình	25.0 °C	Expanded Uncertainty Độ không đảm bảo đo mở rộng	0.12 °C
Temperature Fluctuation Độ dao động	0.2 °C		
Temperature Uniformity Độ đồng đều	0.2 °C		
Temperature Stability Độ ổn định	0.2 °C		

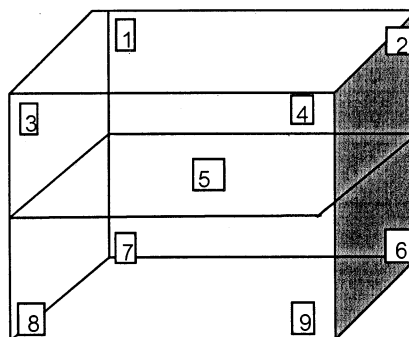


The reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor $k = 2.00$, providing a level of confidence of approximately 95 %

/ Độ không đảm bảo đo mở rộng ước lượng được tính với $k = 2$, mức tin cậy 95%

Remarks:

- As Found: Value before adjust
- As Left: Value after adjusted
- UUT: Unit Under Test / Thiết bị cần hiệu chuẩn

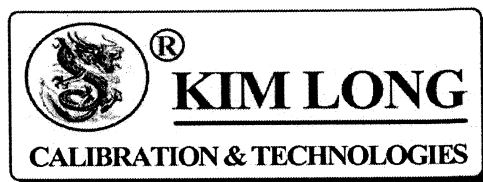

Calibration Report / Biên bản hiệu chuẩn
Report No / Số biên bản: C081118-0037

Manufacturer: EDC-HCM
 Nhà sản xuất:

Model: HB1805-01
 Kiểu:


Asset No / Serial No.: TB-104 / EDC-08082018
 Số quản lý/ Số seri:

3 Temperature Calibration / Hiệu chuẩn nhiệt độ

Set-point= 30.0 °C

Time / Thời gian	Vị trí 1	Vị trí 2	Vị trí 3	Vị trí 4	Vị trí 5	Vị trí 6	Vị trí 7	Vị trí 8	Vị trí 9	Tmax - Tmin
5 min	29.9	30.1	29.9	29.9	30.0	30.0	29.9	30.0	30.1	0.2
10 min	30.1	30.1	30.1	30.0	29.9	30.0	30.0	29.9	30.1	0.2
15 min	30.0	29.9	29.9	30.1	30.1	29.9	30.0	30.1	30.0	0.2
20 min	30.1	30.0	29.9	30.1	30.1	30.0	29.9	30.1	30.1	0.2
25 min	30.0	30.0	30.1	30.1	29.9	30.1	29.9	30.0	29.9	0.2
30 min	29.9	30.0	29.9	30.1	30.0	30.1	30.1	29.9	30.1	0.2
Tmax-Tmin	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	

Average Temperature Nhiệt độ trung bình	30.0 °C	Expanded Uncertainty Độ không đảm bảo đo mở rộng	0.12 °C
Temperature Fluctuation Độ dao động	0.2 °C		
Temperature Uniformity Độ đồng đều	0.2 °C		
Temperature Stability Độ ổn định	0.2 °C		

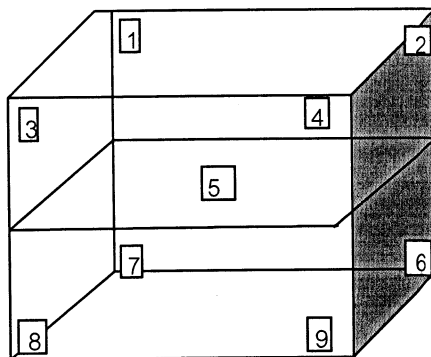


The reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor $k = 2.00$, providing a level of confidence of approximately 95 %

/ Độ không đảm bảo đo mở rộng ước lượng được tính với $k = 2$, mức tin cậy 95%

Remarks:

- As Found: Value before adjust
- As Left: Value after adjusted
- UUT: Unit Under Test / Thiết bị cần hiệu chuẩn

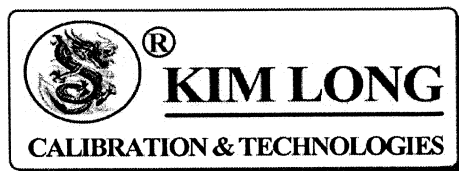

Calibration Report / Biên bản hiệu chuẩn
Report No / Số biên bản: C081118-0037

Manufacturer: EDC-HCM
 Nhà sản xuất:

Model: HB1805-01
 Kiểu:


Asset No / Serial No.: TB-104 / EDC-08082018
 Số quản lý/ Số seri:

4 Temperature Calibration / Hiệu chuẩn nhiệt độ

Set-point= 35.0 °C

Time / Thời gian	Vị trí 1	Vị trí 2	Vị trí 3	Vị trí 4	Vị trí 5	Vị trí 6	Vị trí 7	Vị trí 8	Vị trí 9	Tmax - Tmin
5 min	34.9	35.0	34.9	35.1	35.0	34.9	35.1	35.0	34.9	0.2
10 min	34.9	35.0	35.0	34.9	35.1	35.1	35.1	34.9	34.9	0.2
15 min	35.1	35.1	34.9	35.1	35.0	34.9	34.9	35.1	35.1	0.2
20 min	35.0	35.0	35.1	35.0	34.9	35.0	34.9	35.1	35.1	0.2
25 min	34.9	35.1	35.1	35.1	35.0	35.1	34.9	35.1	35.1	0.2
30 min	35.1	35.0	35.1	35.0	34.9	35.0	35.0	35.1	35.0	0.2
Tmax - Tmin	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	

Average Temperature Nhiệt độ trung bình	35.0 °C	Expanded Uncertainty Độ không đảm bảo đo mở rộng 0.12 °C
Temperature Fluctuation Độ dao động	0.2 °C	
Temperature Uniformity Độ đồng đều	0.2 °C	
Temperature Stability Độ ổn định	0.2 °C	

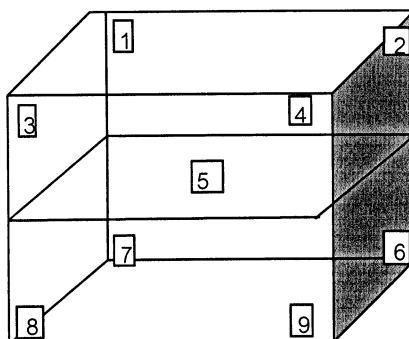


The reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor $k = 2.00$, providing a level of confidence of approximately 95 %

/ Độ không đảm bảo đo mở rộng ước lượng được tính với $k = 2$, mức tin cậy 95%

Remarks:

- As Found: Value before adjust
- As Left: Value after adjusted
- UUT: Unit Under Test / Thiết bị cần hiệu chuẩn

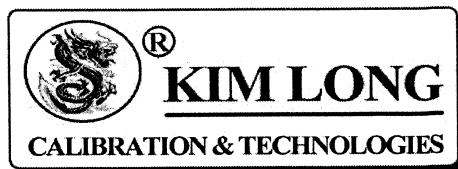

Calibration Report / Biên bản hiệu chuẩn
Report No / Số biên bản: C081118-0037

Manufacturer: EDC-HCM
 Nhà sản xuất:


Model: HB1805-01
 Kiểu:

Asset No / Serial No.: TB-104 / EDC-08082018
 Số quản lý/ Số seri:

5 Temperature Calibration / Hiệu chuẩn nhiệt độ
 Set-point= 40.0 °C

Time / Thời gian	Vị trí 1	Vị trí 2	Vị trí 3	Vị trí 4	Vị trí 5	Vị trí 6	Vị trí 7	Vị trí 8	Vị trí 9	Tmax - Tmin
5 min	39.9	40.1	39.9	40.1	40.1	39.9	39.9	39.9	40.0	0.2
10 min	40.0	40.0	39.9	39.9	39.9	40.1	40.1	39.9	40.0	0.2
15 min	40.1	39.9	39.9	40.1	40.1	39.9	40.0	39.9	39.9	0.2
20 min	40.0	40.1	40.1	39.9	40.0	40.0	39.9	40.1	39.9	0.2
25 min	40.1	40.0	40.0	40.0	40.1	40.0	39.9	40.0	39.9	0.2
30 min	39.9	40.0	40.0	40.1	40.1	40.1	40.1	40.0	40.0	0.2
Tmax- Tmin	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	

Average Temperature Nhiệt độ trung bình	40.0 °C	Expanded Uncertainty Độ không đảm bảo đo mở rộng	0.12 °C
Temperature Fluctuation Độ dao động	0.2 °C		
Temperature Uniformity Độ đồng đều	0.2 °C		
Temperature Stability Độ ổn định	0.2 °C		

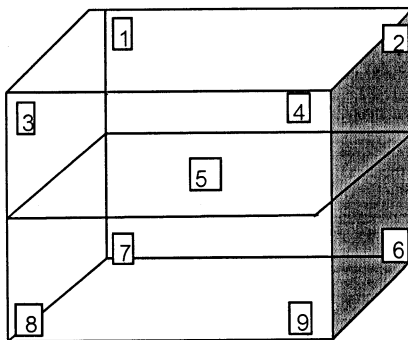


The reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor $k = 2.00$, providing a level of confidence of approximately 95 %

/ Độ không đảm bảo đo mở rộng ước lượng được tính với $k = 2$, mức tin cậy 95%

Remarks:

- As Found: Value before adjust
- As Left: Value after adjusted
- UUT: Unit Under Test / Thiết bị cần hiệu chuẩn

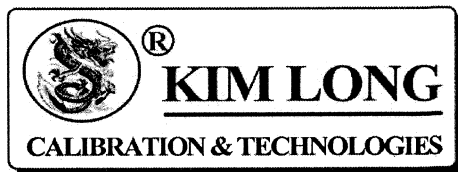

Calibration Report / Biên bản hiệu chuẩn

Report No / Số biên bản: C081118-0037

Manufacturer: EDC-HCM

Nhà sản xuất:

Model: HB1805-01

Kiểu:

Asset No / Serial No.: TB-104 / EDC-08082018


Số quản lý/ Số seri:

6 Temperature Calibration / Hiệu chuẩn nhiệt độ

Set-point= 45.0 °C

Time / Thời gian	Vị trí 1	Vị trí 2	Vị trí 3	Vị trí 4	Vị trí 5	Vị trí 6	Vị trí 7	Vị trí 8	Vị trí 9	Tmax - Tmin
5 min	45.1	45.0	45.1	45.1	45.0	45.0	45.1	44.9	44.9	0.2
10 min	45.1	45.1	44.9	44.9	44.9	45.1	45.1	45.0	45.0	0.2
15 min	44.9	45.0	45.1	44.9	45.0	44.9	45.0	45.0	44.9	0.2
20 min	44.9	44.9	45.1	45.0	45.0	45.0	45.0	44.9	45.0	0.2
25 min	44.9	45.0	45.0	45.0	45.1	44.9	45.1	44.9	45.0	0.2
30 min	45.0	44.9	45.0	44.9	45.1	44.9	44.9	45.1	45.0	0.2
Tmax - Tmin	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	

Average Temperature Nhiệt độ trung bình	45.0 °C	Expanded Uncertainty Độ không đảm bảo đo mở rộng	0.12 °C
Temperature Fluctuation Độ dao động	0.2 °C		
Temperature Uniformity Độ đồng đều	0.2 °C		
Temperature Stability Độ ổn định	0.2 °C		

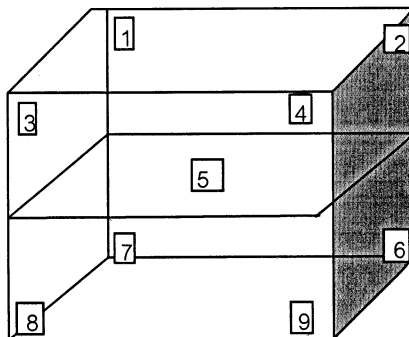


The reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor $k = 2.00$, providing a level of confidence of approximately 95 %

/ Độ không đảm bảo đo mở rộng ước lượng được tính với $k = 2$, mức tin cậy 95%

Remarks:

- As Found: Value before adjust
- As Left: Value after adjusted
- UUT: Unit Under Test / Thiết bị cần hiệu chuẩn

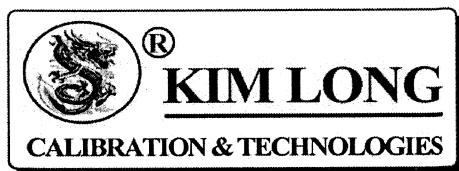

Calibration Report / Biên bản hiệu chuẩn

Report No / Số biên bản: C081118-0037

Manufacturer: EDC-HCM

Nhà sản xuất:

Model: HB1805-01

Kiểu:

Asset No / Serial No.: TB-104 / EDC-08082018


Số quản lý/ Số seri:

7 Humidity Calibration / Hiệu chuẩn độ ẩm

Set-point= 40.0 %RH

Time / Thời gian	Vị trí 1	Vị trí 2	Vị trí 2	Tmax - Tmin
5 min	40.2	40.2	40.1	0.1
10 min	40.2	39.9	40.0	0.3
15 min	40.0	40.2	40.2	0.2
20 min	40.1	40.0	40.2	0.2
25 min	39.9	40.2	40.0	0.3
30 min	40.0	40.0	39.9	0.1
Tmax - Tmin	0.3	0.3	0.3	

Average Temperature Nhiệt độ trung bình	40.1 %RH	Expanded Uncertainty Độ không đảm bảo đo mở rộng	1.7 %RH
Temperature Fluctuation Độ dao động	0.3 %RH		
Temperature Uniformity Độ đồng đều	0.3 %RH		
Temperature Stability Độ ổn định	0.3 %RH		

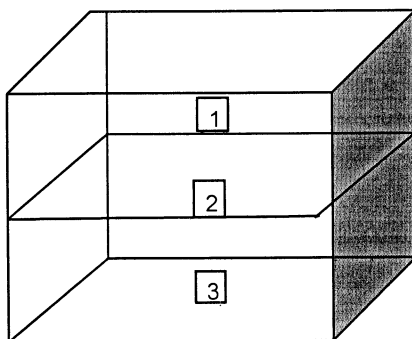

The reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor $k = 2.00$, providing a level of confidence of approximately 95 %

/ Độ không đảm bảo đo mở rộng ước lượng được tính với $k = 2$, mức tin cậy 95%

Remarks:

- As Found: Value before adjust
- As Left: Value after adjusted
- UUT: Unit Under Test / Thiết bị cần hiệu chuẩn



Calibration Report / Biên bản hiệu chuẩn

Report No / Số biên bản: C081118-0037

Manufacturer: EDC-HCM

Nhà sản xuất:

Model: HB1805-01

Kiểu:

Asset No / Serial No.: TB-104 / EDC-08082018


Số quản lý/ Số seri:

8 Humidity Calibration / Hiệu chuẩn độ ẩm

Set-point= 50.0 %RH

Time / Thời gian	Vị trí 1	Vị trí 2	Vị trí 2	Tmax - Tmin
5 min	50.2	50.1	49.9	0.3
10 min	50.4	49.9	49.9	0.5
15 min	50.3	50.1	49.9	0.4
20 min	50.4	50.0	50.0	0.4
25 min	50.2	49.9	50.2	0.3
30 min	50.2	50.2	49.9	0.3
Tmax - Tmin	0.2	0.3	0.3	

Average Temperature Nhiệt độ trung bình	50.0 %RH	Expanded Uncertainty Độ không đảm bảo đo mở rộng	2.0 %RH
Temperature Fluctuation Độ dao động	0.5 %RH		
Temperature Uniformity Độ đồng đều	0.5 %RH		
Temperature Stability Độ ổn định	0.3 %RH		

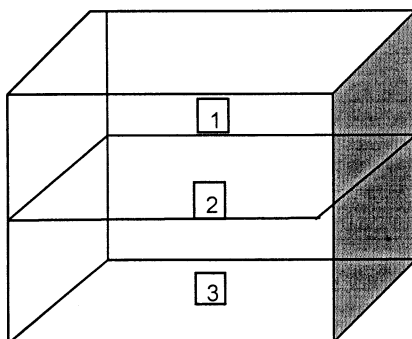

The reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor $k = 2.00$, providing a level of confidence of approximately 95 %

/ Độ không đảm bảo đo mở rộng ước lượng được tính với $k = 2$, mức tin cậy 95%

Remarks:

- As Found: Value before adjust
- As Left: Value after adjusted
- UUT: Unit Under Test / Thiết bị cần hiệu chuẩn



Calibration Report / Biên bản hiệu chuẩn

Report No / Số biên bản: C081118-0037

Manufacturer: EDC-HCM

Nhà sản xuất:

Model: HB1805-01

Kiểu:

Asset No / Serial No.: TB-104 / EDC-08082018


Số quản lý/ Số seri:

9 Humidity Calibration / Hiệu chuẩn độ ẩm

Set-point= 60.0 %RH

Time / Thời gian	Vị trí 1	Vị trí 2	Vị trí 2	Tmax - Tmin
5 min	60.3	60.2	60.0	0.3
10 min	60.4	60.2	60.1	0.3
15 min	60.3	60.1	59.9	0.4
20 min	60.4	60.1	60.1	0.3
25 min	60.3	60.1	59.9	0.4
30 min	60.2	60.2	60.1	0.1
Tmax - Tmin	0.2	0.1	0.2	

Average Temperature Nhiệt độ trung bình	60.1 %RH	Expanded Uncertainty Độ không đảm bảo đo mở rộng	2.2 %RH
Temperature Fluctuation Độ dao động	0.5 %RH		
Temperature Uniformity Độ đồng đều	0.4 %RH		
Temperature Stability Độ ổn định	0.2 %RH		

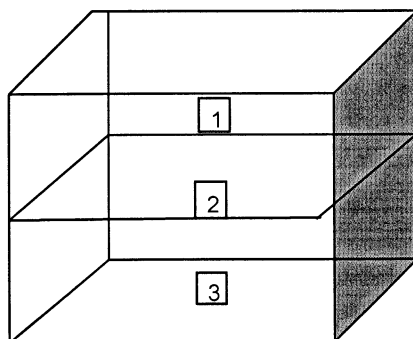

The reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor $k = 2.00$, providing a level of confidence of approximately 95 %

/ Độ không đảm bảo đo mở rộng ước lượng được tính với $k = 2$, mức tin cậy 95%

Remarks:

- As Found: Value before adjust
- As Left: Value after adjusted
- UUT: Unit Under Test / Thiết bị cần hiệu chuẩn



Calibration Report / Biên bản hiệu chuẩn
Report No / Số biên bản: C081118-0037

Manufacturer: EDC-HCM
 Nhà sản xuất:

Model: HB1805-01
 Kiểu:


Asset No / Serial No.: TB-104 / EDC-08082018
 Số quản lý/ Số seri:

10 Humidity Calibration / Hiệu chuẩn độ ẩm

Set-point= 70.0 %RH

Time / Thời gian	Vị trí 1	Vị trí 2	Vị trí 2	Tmax - Tmin
5 min	70.0	70.2	70.4	0.4
10 min	70.2	70.3	70.2	0.1
15 min	69.9	70.1	70.2	0.3
20 min	70.1	69.9	70.1	0.2
25 min	69.9	70.1	70.2	0.3
30 min	70.0	70.2	70.1	0.2
Tmax-Tmin	0.3	0.4	0.3	

Average Temperature Nhiệt độ trung bình	70.1 %RH	Expanded Uncertainty Độ không đảm bảo đo mở rộng	2.5 %RH
Temperature Fluctuation Độ dao động	0.5 %RH		
Temperature Uniformity Độ đồng đều	0.4 %RH		
Temperature Stability Độ ổn định	0.4 %RH		

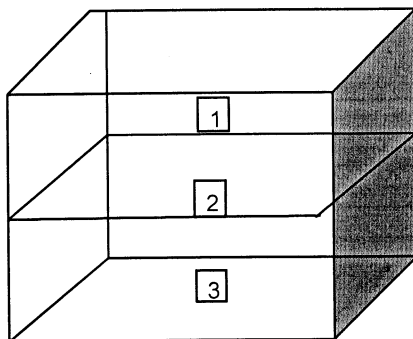


The reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor $k = 2.00$, providing a level of confidence of approximately 95 %

/ Độ không đảm bảo đo mở rộng ước lượng được tính với $k = 2$, mức tin cậy 95%

Remarks:

- As Found: Value before adjust
- As Left: Value after adjusted
- UUT: Unit Under Test / Thiết bị cần hiệu chuẩn

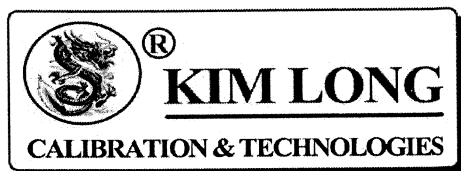

Calibration Report / Biên bản hiệu chuẩn
Report No / Số biên bản: C081118-0037

Manufacturer: EDC-HCM
 Nhà sản xuất:

Model: HB1805-01
 Kiểu:


Asset No / Serial No.: TB-104 / EDC-08082018
 Số quản lý/ Số seri:

11 Humidity Calibration / Hiệu chuẩn độ ẩm

Set-point= 80.0 %RH

Time / Thời gian	Vị trí 1	Vị trí 2	Vị trí 2	Tmax - Tmin
5 min	80.3	80.0	79.9	0.4
10 min	80.0	80.0	80.2	0.2
15 min	80.1	80.1	80.0	0.1
20 min	80.3	80.2	80.0	0.3
25 min	80.2	79.9	80.2	0.3
30 min	79.9	79.9	80.1	0.2
Tmax-Tmin	0.4	0.3	0.3	

Average Temperature Nhiệt độ trung bình	80.1 %RH	Expanded Uncertainty Độ không đảm bảo đo mở rộng	2.7 %RH
Temperature Fluctuation Độ dao động	0.4 %RH		
Temperature Uniformity Độ đồng đều	0.4 %RH		
Temperature Stability Độ ổn định	0.4 %RH		

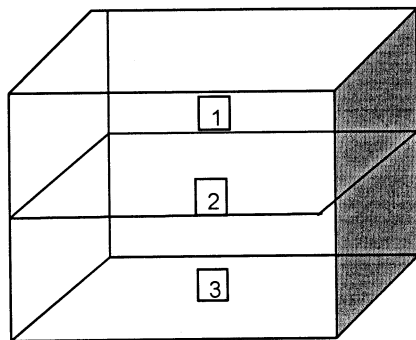

The reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor $k = 2.00$, providing a level of confidence of approximately 95 %

/ Độ không đảm bảo đo mở rộng ước lượng được tính với $k = 2$, mức tin cậy 95%

Remarks:

- As Found: Value before adjust
- As Left: Value after adjusted
- UUT: Unit Under Test / Thiết bị cần hiệu chuẩn

Certified By Technician:


Kỹ thuật thực hiện



Huynh Trung Kien

Quality Inspector:

QC kiểm duyệt



Cao Cam Giang